





メッシュを摘出

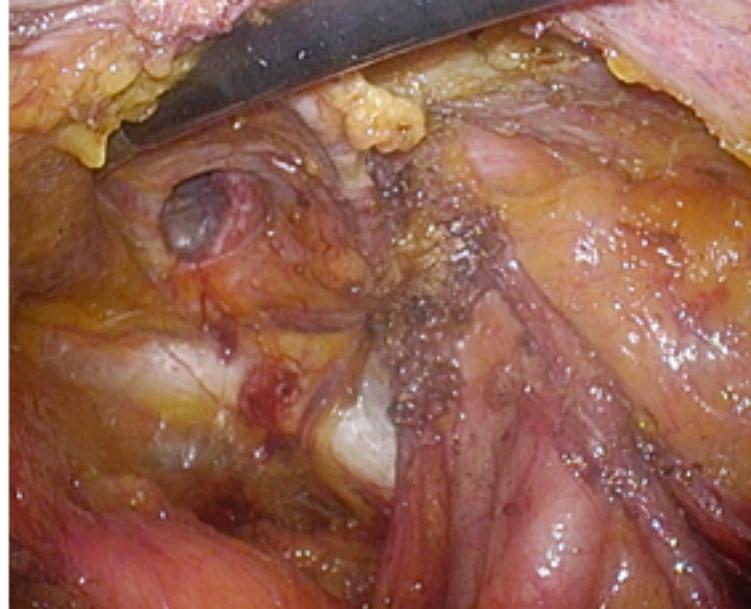

内側のヘルニアを確認

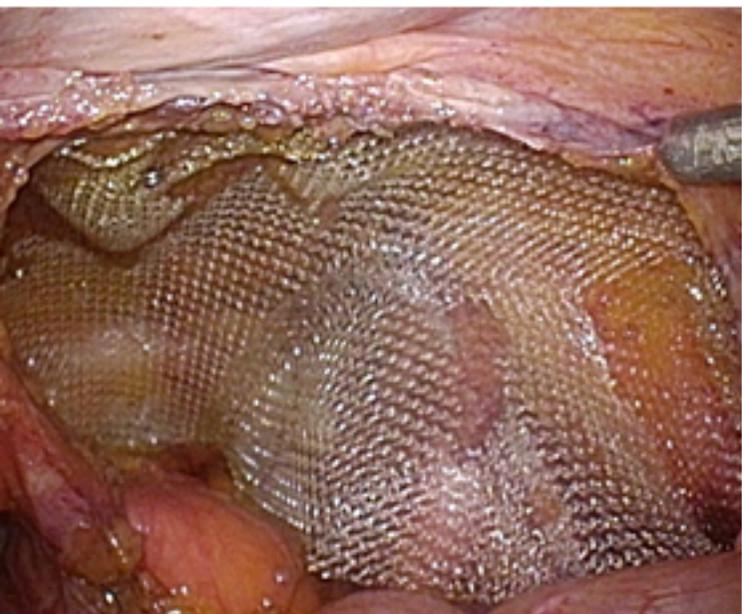

新しいメッシュで広く覆う